

## Terviseamet hoiatab võltsitud COVID-19 antigeeni kiirtestide eest

Terviseamet hoiatab võltsitud COVID-19 antigeeni kiirtestide eest. Testi tootjaks on Beijing Hotgen Biotech Co., LTD. Volitatud esindajaks on MedNet GmbH. Tuvastatud võltsitud test oli seerianumbriga W2021080500.


Kuidas eristada võltsitud testi?

1. Testi pakendi erinevused:

### Võltsitud test



### Nõuetele vastav test

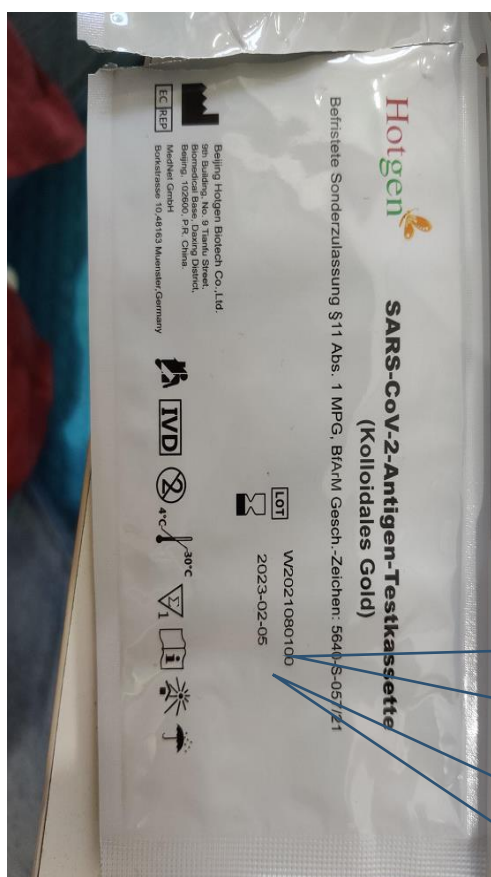

## 2. Testkasseti erinevused:

### Võltsitud test




Erinevus 1:  
võltsitud  
testimiskassetil  
on väike  
ava/aken.

### Nõuetele vastav test



Erinevus 1:  
nõuetele  
vastaval  
testimiskasse  
til on suur  
ava/aken.





Kui teil on kahtlusi või küsimusi, siis pöörduge terviseameti meditsiiniseadmete osakonna poole  
[mso@terviseamet.ee](mailto:mso@terviseamet.ee)